


静岡県外科医会第251回集談会

日本臨床外科学会 静岡県支部

第251回集談会を下記により開催致しますので万障お繰り合わせの上
多数のご出席をお願い申し上げます。

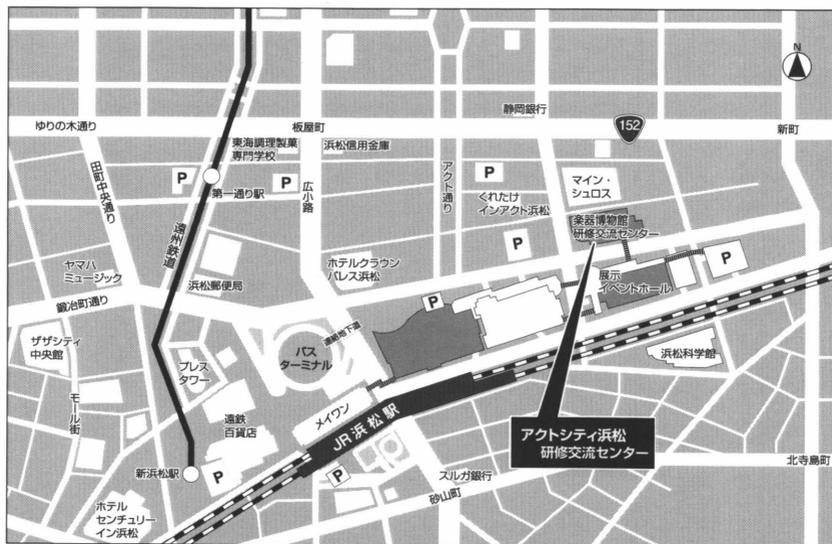

日時 令和7年3月1日(土)
13:30より

会場 アクトシティ浜松
研修交流センター
51・52研修交流室
浜松市中央区中央3丁目9-1

特別講演

「医療補償制度創設に向けて」

大磯 義一郎 先生 (浜松医科大学医療法学 教授)

※日本医師会生涯教育制度に2.5単位申請中です。

単位認定のために、医籍登録番号を受付で記入していただけます。
ご自身の医籍登録番号をご確認くださいようお願い申し上げます。

- (1) 今回の演題発表は、症例報告が1題4分、討論4分です。発表時間を厳重に守ってください。
- (2) フロアからの質問は、座長の指示に従ってください。
- (3) スライドは、8枚を目安としますが時間内であれば枚数調整可とします。
- (4) 抄録を変更される方は、当日必ずご持参ください。
- (5) PC・プロジェクターは、各会場に用意してあります。
- (6) 演者並びに共同演者は、会員に限ります。会員会費未納者は会場でいただきます。
- (7) 内規により第167回から参加費として1,000円いただいております。

令和7年3月

第251回集談会 会長

落合 秀人 (浜松医療センター 副院長)

当番幹事

藤田 博文 (社会福祉法人 聖隷福祉事業団 総合病院 聖隷三方原病院)

木俣 博之 (木俣外科消化器科医院)

奥田 康一 (浜松赤十字病院健康管理センター)

西脇 由朗 (西脇医院)

大久保 忠俊 (大久保外科・消化器科医院)

鈴木 正彦 (JA 静岡厚生連遠州病院)

宮地 正彦 (中東遠総合医療センター)

滝浪 實 (滝浪ハートクリニック)

吉田 雅行 (社会福祉法人 聖隷福祉事業団 聖隷健康診断センター)

鈴木 一史 (社会福祉法人 聖隷福祉事業団 総合病院 聖隷浜松病院)

静岡県外科医会 会長

海野 直樹 (浜松医療センター 院長)

◎お問い合わせは下記にお願いいたします。

〒432-8580 静岡県浜松市中央区富塚町328番地

浜松医療センター 消化器外科

落合 秀人 宛

E-mail : hydeochi@hmedc.or.jp

TEL : 053-453-7111

静岡県外科医会第252回集談会のご案内

日 時：2025年9月6日（土）または13日（土）の予定 13：30～

会 場：プラサヴェルデ（静岡県沼津市大手町1-1-4）の予定

演題申込：

【Webからのお申込】

・日本臨床外科学会のホームページよりお申し込みいただくことが可能です。

URL：<http://www.ringe.jp/>

※日本臨床外科学会のHPよりご登録いただく場合は、日本臨床外科学会の会員登録が必要となります。

1) 日本臨床外科学会のトップページ 更新情報の「静岡県外科医会 第252回集談会 開催と演題募集のご案内」を選択してください。

2) 〈会員の方〉「会員の方はこちら」を選択してください。Web会員登録がお済みの方は、会員番号とパスワードを入力してお進みください。Web会員登録がお済みでない方は、Web会員登録を行ってください。

〈会員登録がお済みでない方〉「会員登録がお済みでない方」を選択してください。会員登録の手続きを行ってください。

〈研修医の方〉「研修医の方はこちら」を選択してください。Web登録用のIDを取得して、先にお進みください。

【メールでのお申込】

演題名、所属（所属が異なれば改行）、発表者、共同発表者、抄録の順に、抄録本文を400字程度で作成し、Wordデータでお送りください。送付の際、件名を「第252回集談会 演題申込」としてください。

〈送付先〉E-mail：info@jsa-shizu.com

演題締切：2025年7月1日（火）必着

第252回集談会 会 長 伊藤 智彰（順天堂大学医学部附属静岡病院 外科 教授）
当番幹事 佐藤 浩一、池田 誠、川村 雅彦、坪佐 恭宏、小野 憲、
川辺 昭浩、梶本 徹也、利野 靖、菅本 祐司、角 泰廣、
吉田 剛

静岡県外科医会 会 長 海野 直樹（浜松医療センター 院長）

◎お問い合わせは下記にお願いいたします。

〒410-2295

静岡県伊豆の国市長岡1129

順天堂大学医学部附属静岡病院 外科

伊藤 智彰 宛

E-mail：tomo-ito@juntendo.ac.jp

TEL：055-948-3111

静岡県外科医会集談会 演者の先生へ お知らせとお願い

発表形式は、PC（Windows）のプレゼンテーションのみとなります。

1. 当日の演題提出は、発表30分前までに受付を済ますようにお願いします。（以降の変更不可）
2. OSは、Windowsのみです。
3. プレゼンテーション作成ソフトは、Windows版PowerPoint（バージョン2003以降）を使用してください。文字フォントは、Windows標準のものをご使用ください。これ以外の文字フォントを使用した場合は、文字、段落のくずれ、文字化け、表示されないなどのトラブルが発生する可能性があります。
4. 動画の解像度は、フルHD（1920×1080）です。解像度がこれより大きい場合は、画面の周囲が切れてしまうことがありますのでご注意ください。
5. お持ち込みいただけるメディアは、USBフラッシュメモリーです。
6. メディアには、当日発表されるデータ以外のデータは入れないようにしてください。データのファイル名には、演題番号（半角）、発表者の氏名（漢字）を必ず入れてください。
7. 動画をご使用の場合は、PowerPointとのリンク状態を保つため、動画ファイルも同じフォルダに保存してください。ファイル形式は、Windows Media Playerで動作するファイル形式（推奨：WMV形式）をご使用ください。動画をご使用の場合は、ご自身のPCを、お持ち込みいただくことをお勧めいたします。なお、音声はご使用になれませんことをあらかじめご了承ください。
8. 不意のアクシデントに備え、バックアップデータをご持参ください。PCに取り込んだ発表データは、主催者で責任をもって消去いたします。
9. スライド枚数は、8枚を目安としますが、時間内であれば枚数調整可とします。
10. PCをご持参される方は、外部出力ディスプレイが可能であることを必ずご確認ください。また、バッテリー切れを防ぐため、電源アダプターをご持参ください。お持ち込みPCの外部モニター出力端子の形状を必ず確認し、必要な場合は、接続用の端子をご持参ください。接続は、HDMI端子となります。
11. スライド操作は、先生ご自身でお願いいたします。
12. 発表終了1分前に1回、発表終了時に2回、討論終了時に3回、ベルを鳴らします。

A会場

13:30～

〈開会の辞〉 落合 秀人（浜松医療センター）

演題

A-I 13:35～14:20

座長 戸松 真琴（聖隷浜松病院） 討論者 松本 知拓（浜松医科大学）

1. 特発性食道破裂に対する治療戦略

国立大学法人 浜松医科大学
外科学第二講座*
国立大学法人 浜松医科大学
周術期等生活機能支援学講座**

松本知拓*、坊岡英祐*、境井勇氣*、
羽田綾馬*、曾根田 亘*、村上智洋*、
森田剛文*、菊池寛利*、平松良浩**、
竹内裕也*

2. 小腸 angioectasia からの出血に対し小腸切除を施行した一例

JA 静岡厚生連 静岡厚生病院 外科

酒井隆行、河南晴久、西村廣大、
島村隆浩、水野伸一

3. 青色ゴムまり様母斑症候群（blue rubber bleb nervus syndrome）による多発消化管血管腫に対して開腹下小腸内視鏡を施行し貧血の改善を認めた一例

地方独立行政法人 静岡県立病院機構
静岡県立総合病院 消化器外科

野瀬暉誠彦、西子瑞規、櫻庭駿介、
中村和正、小井土耕平、大島健志、
間 浩之、大端 考、渡邊昌也、
佐藤真輔、金本秀行

4. 小腸間膜裂孔ヘルニアによる絞扼性腸閉塞の1例

富士宮市立病院 外科

李 光貴、磯垣 淳、秋元亜生、
刑部夢望、稲守宏治、矢島澄鎮、
奥村拓也、山下公裕、小倉廣之、
川辺昭浩

5. 細径鉗子「Endo Relief」併用の単孔式腹腔鏡下腸管癒着剥離術を施行した、
ERCP後膵炎に伴う小腸癒着性イレウスの1例

地方独立行政法人 静岡市立静岡病院
外科・消化器外科

小林敏樹、柴田知佐、近森健太郎、
西谷健太、矢崎真澄、多田誠一郎、
川守田啓介、高柳智保、佐々木直也、
橋本洋右、米沢 圭、前田賢人

A - II 14:20~14:55

座長 神藤 修 (磐田市立総合病院) 討論者 田村 浩章 (浜松医療センター)

6. S状結腸間膜窩ヘルニアの4例

磐田市立総合病院 外科

本康佑歩、神藤 修、日高のぞみ、
杉村 朗、安本周平、村木隆太、
鈴木克徳、斉藤貴明、川端俊貴、
宇野彰晋、深澤貴子、松本圭五、
坂口孝宣、鈴木昌八

7. 小児期の左股関節脱臼手術の腹壁癒着ヘルニアの1例

社会福祉法人 聖隷福祉事業団 総合病院
聖隷浜松病院 外科・ヘルニアセンター

植田浩太、宮木祐一郎、戸松真琴、
鈴木一史

8. 成人男性に発症した右横隔膜ヘルニア陥頓の一例

浜松医療センター 消化器外科

清水雄嗣、大菊正人、小関海都、
一瀬健太、見原遥佑、河西 怜、
川村崇文、原田 岳、稲葉圭介、
田村浩章、落合秀人

9. 腹壁デスマイド型線維腫症の1例

社会福祉法人 聖隷福祉事業団 総合病院
聖隷三方原病院 消化器外科

内藤 健、藤田博文、山川純一、
山根秘我、橋渡七奈子、松尾智暁、
光定健太、田原俊哉、丸山翔子、
秋山真吾、木村泰生

静岡県外科医会 総会

15：10～15：40 （A会場）

特別講演

15：40～16：30 （A会場）

「医療補償制度創設に向けて」

演者 大磯 義一郎（国立大学法人 浜松医科大学医療法学 教授）

A - III 16：35～17：20

座長 落合 秀人（浜松医療センター） 討論者 前田 隆雄（JA 静岡厚生連遠州病院）

10. 腹腔内に多発した炎症性偽腫瘍の1例

静岡県立総合病院 消化器外科*

静岡県立総合病院 病理診断科**

山本大智*、瀧 雄介*、鈴木 誠**、

永井恵里奈*、西田正人*、佐藤真輔*、

渡邊昌也*、大端 考*、金本秀行*

11. 劇症型溶連菌感染症による腹膜炎に対して集学的治療を行い救命し得た一例

国立大学法人 浜松医科大学

外科学第二講座*

国立大学法人 浜松医科大学

外科学第一講座**

小山夏輝*、杉山洸裕*、倉地清隆*、

阪田麻裕*、鳥居 翔**、赤井俊也*、

小嶋忠浩*、立田協太*、岩瀬友哉*、

高木 徹*、竹内裕也*

12. 悪性腫瘍との鑑別のために腹腔鏡下生検を施行した外傷性脾損傷後 Splenosis の1例

浜松医療センター 消化器外科

小関海都、原田 岳、一瀬健太、

見原遙佑、河西 怜、清水雄嗣、

川村崇文、大菊正人、稲葉圭介、

田村浩章、落合秀人

13. 直腸腫瘍に対してエストリオール投与で治癒した1例

社会福祉法人 聖隷福祉事業団 総合病院
聖隷浜松病院 外科

坂根舜哉、小林靖幸、植田浩太、
佐藤純人、浜野 孝、鈴木一史

14. 外科専攻医による消化器外科領域ロボット支援手術

社会福祉法人 聖隷福祉事業団 総合病院
聖隷三方原病院 外科

橋渡七奈子、木村泰生、松尾智暁、
光定健太、渡邊 健、田原俊哉、
丸山翔子、秋山真吾、山川純一、
山根秘我、藤田博文

閉会の辞 伊藤 智彰 (順天堂大学医学部附属静岡病院)

B会場

13:30～

〈開会の辞〉 藤田 博文 (社会福祉法人 聖隷福祉事業団 総合病院 聖隷三方原病院)

演 題

B-I 13:35～14:20

座長 川村 崇文 (浜松医療センター) 討論者 立田 協太 (浜松医科大学)

1. S状結腸穿孔に対して緊急で腹腔鏡下に治療を行った1例

社会福祉法人 恩賜財団済生会
静岡済生会 総合病院 外科

福井史弥、鈴木 潔、土屋智敬、
西前香寿、田中征洋、川上次郎、
張 丹、寺崎正起、岡本好史

2. 門脈ガス血症をきたした特発性上行結腸壊死の1例

JA 静岡厚生連 遠州病院 外科

水谷文光也

3. Type 4 病変との別を要したクローン類似病変を有する直腸癌の1例

静岡市立清水病院 外科*
静岡市立清水病院 病理診断科**

石岡直留*、石松久人*、小路 毅*、
木内亮太*、紅林 泰**、丸尾啓敏*

4. S状結腸穿孔を併存した出血性CMV腸炎の1例

焼津市立総合病院 外科 脳神経内科

杉山 健、川口萌々子、五十嵐 洸、
村井 伸、牧野晃大、小野田貴信、
石原行雄、北 雄介、高林直記、
小林 亮、平松毅幸、風間伸介、
内田宗吾

5. 経肛門的直腸異物の4例

掛川市・袋井市病院企業団立
中東遠総合医療センター 外科

石田万智、河合 徹、京兼隆典、
相場利貞、中橋剛一、深田浩志、
斉藤大佑、池田幸陽、久世真悟、
宮地正彦

【第248回集談会 優秀演題】（令和5年9月2日 浜松）

○A会場

A-Ⅲ-12

「妊娠23週妊婦の胆嚢炎に対して腹腔鏡下胆嚢摘出術を施行した1例」

JA厚生連遠州病院 外科 寺本 圭佑

○B会場

B-Ⅲ-12

「重症体幹部外傷の一救命例

～重症外傷救命のためには、適切な外科的治療戦略が不可欠である～」

社会福祉法人 聖隷福祉事業団 総合病院 聖隷浜松病院 肝胆膵外科 山本 博崇

【第249回集談会 優秀演題】（令和6年3月16日 沼津）

○A会場

A-Ⅳ-17

「慢性胆嚢炎合併左側胆嚢の一部切除」

富士宮市立病院 外科 猪瀬 祐気

○B会場

B-Ⅱ-9

「中枢嵌頓から緊急手術を要した大腿ヘルニアの2例」

富士市立中央病院 田地野 将太

※第248回、249回の優秀演題賞はすでに受賞者へ送付済みにて表彰式は行いません。

【第250回集談会 優秀演題】 (令和6年9月14日 静岡)

○A会場

A-I-1

「右鎖骨下動脈起始異常を伴う食道癌に対し、頸部操作先行で胸腔鏡下食道切除術を施行した2例」

静岡県立静岡がんセンター 食道外科 木部 葉奈

A-II-9

「内ヘルニアにより絞挽性腸閉塞をきたした腹壁破裂術後の非定型的な腸回転異常症の一例」

静岡県立こども病院 外科(小児外科・成育外科) 山城 優太郎

A-III-12

「緊急手術を必要とした狭窄型の虚血性腸炎の1例」

静岡県立総合病院 消化器外科 溝口 和弥

○B会場

B-I-2

「当院でのトリプルネガティブ乳がんにおける術前化学療法としてのPembrolizumabの使用経験～乳腺外科医に身近となった副腎不全～」

静岡赤十字病院 外科 松島 宏和

B-III-14

「続発性会陰ヘルニアに対する腹腔鏡下修復術の経験」

社会福祉法人 聖隷福祉事業団 総合病院 聖隷浜松病院 外科 植田 浩太

★【第250回集談会 最優秀賞】

B-II-10

「非乳頭部十二指腸神経内分泌癌に対し臍頭十二指腸切除を施行した1例」

社会福祉法人 聖隷福祉事業団 総合病院 聖隷三方原病院 外科 山根 秘我



■効能又は効果、用法及び用量、警告・禁忌を含む注意事項等情報等については、電子添文をご参照ください。

経口FXa阻害剤

処方箋医薬品[※] 薬価基準収載

エリキュース[®]錠 2.5mg
5mg

Eluquis. (アピキサラン錠)
apixaban/tables

注) 注意—医師等の処方箋により使用すること

製造 プリストル・マイヤーズ スクイブ株式会社

販売元 〒100-0004 東京都千代田区大手町1-2-1
文部科学省及び関心分野の専門家グループ TEL: 0120-093-507
販売情報提供活動に関するお問い合わせ窓口 TEL: 0120-407-200

販売元 ファイザー株式会社

〒151-8589 東京都渋谷区代々木3-22-7
文部科学省及び関心分野の専門家グループ
製品情報センター— 手術情報ダイヤル 0120-664-467
販売情報提供活動に関するご意見: 0120-407-947

2022年10月作成
432-JP-220035202/ELQ72F006H

医療を支え、
世界の人々の健康に貢献する

Support medical care and contribute to
people's health around the world.



私たちA&Tは、1978年のグルコース分析装置から始まり、
臨床検査の分野における独自の製品と技術の研究開発に取り組んできました。
時代とともに変化していく臨床検査の現場に、常に新たな「提案」ができる存在でありたい。
私たちは世界に向かって、未来に向かって挑戦を続けます。



株式会社 エイアンドティー

〒221-0056 神奈川県横浜市神奈川区金港町2-6 横浜プラザビル
Tel.045(440)5810  <https://www.aandt.co.jp/>



病院スタッフ、患者様の安全安心を守る

24時間 病院警備のPRO

創業45年、私たちは施設警備と
交通誘導警備を時代に則して追求する
プロ集団です

東和セキュリティ株式会社
代表取締役 内山達也

〒430-0946 浜松市中央区元城町113-15

わたしたちが健康な毎日をサポートします。

医療機器販売事業

- 先端医療機器・医療用具・消耗品の販売
- 医療機器の修理及びメンテナンス

開業支援サービス事業

- 開業支援サービス

介護サービス事業

- 福祉用具のレンタル
- 介護・看護用品の販売
- 住宅改修



あかるいヘルスケアのために

株式会社 **マストレメディカル**

<http://www.masutore.co.jp>

マストレメディカル


検索

本社 〒431-3122 静岡県浜松市東区有玉南町 2365

TEL / 053-474-5656 (代) FAX / 053-471-5041

岡崎営業所 〒444-0854 愛知県岡崎市六名本町 20-3

TEL / 0564-57-8120 FAX / 0564-54-1399

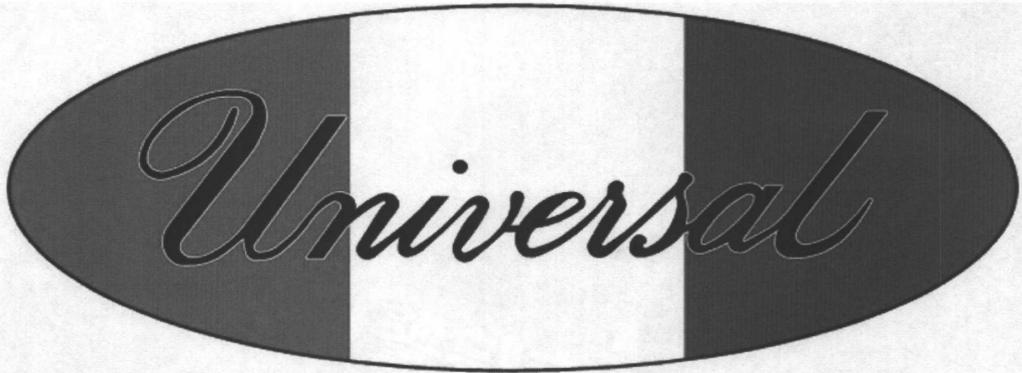

ユニバーサル商事株式会社

自動省力無人化機器システム

〒 435-0052 浜松市中央区天王町141

TEL 053 - 421 - 3141 (代表)

FAX 053 - 421 - 3147

<http://www.universal-shoji.co.jp/>



地域密着 創業60年



株式会社 マツイ

医療機器販売・新規開業サポート

<http://matsui-medical.co.jp/>

TEL 053-421-0681 FAX 053-421-7902
〒 435-0051 静岡県浜松市中央区市野町 1880

調剤の現場を支えること。 人と未来をつなぐ。

トーショーは、医療や調剤の現場で働く方々や患者さまのことを考え、それぞれの現場に応じた機械やシステムの提供を行っています。



※掲載内容は2024年7月19日現在のものです。

製品開発からアフターフォローまで。当社は「総合力」で医療現場を支えます。

調剤機器製品
製造・販売

システム構築

空間設計

TOSHO
Your best pharmacy solution

株式会社トーショー
本社 〒144-0033 東京都大田区東糀谷3-8-8

■お問合せ先 9:00~17:00 (平日)
TEL (03) 3745-1331 (代)

トーショー公式サイト
<https://www.tosho.cc/>



QuidelOrtho™

- 胸痛マーカーを全血から約20分で迅速報告
- シンプルで効果的な運用を提供
- POC・災害時・救急現場で活用可能
- “検体検査の質の確保”をサポート

大きさ	W190×D225×H70mm	0.7kg	検体	全血・血漿 (EDTA)
電源	AC電源/単三乾電池4本		測定時間	約20分/Test
測定項目	cTnI, Myo, CK-MB, DD, NT-proBNP			

Triage® 移動式免疫蛍光分析装置
トリアージ™ メータープロ

オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックスは、カイデル社との統合により、ブランドロゴ、カラーの変更を行いました。2社の統合後は、POCT製品がラインナップに加わり、日本の医療に、より一層貢献できると確信しております。オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス株式会社を、ご愛顧くださいますようお願いいたします。

製造販売元：
オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス株式会社
〒141-0032 東京都品川区大崎1-11-2 ゲートシティ大崎イーストタワー
お客様サポートセンター：0120 98-7350 | quidelortho.com/jp/ja



特許取得済みの機器
販売元：トリアージメータープロ | 届出番号：13B3X10J200001

© QuidelOrtho 2024 PR-106470-JPN-IA-V1

亜鉛

体外診断用医薬品

製造販売承認番号 21700AMZ00817000

自動分析装置用試薬

汎用検査用亜鉛キット

アキュラスオート Zn

■包装単位■

品名	識別記号	規格
アキュラスオート Zn		
R-I 緩衝液		12 mL × 2
R-II 呈色液		5.5 mL × 2
アキュラスオート Zn		
R-I 緩衝液	HLS	28.6 mL × 2
R-II 呈色液		12.2 mL × 2
アキュラスオート Zn		
R-I 緩衝液	(55)	20 mL × 2
R-II 呈色液		9.5 mL × 2
アキュラスオート Zn		
R-I 緩衝液	(E) (20)	20.0 mL × 2
R-II 呈色液		8.9 mL × 2
アキュラスオート Zn		
R-I 緩衝液	(E)	49.5 mL × 2
R-II 呈色液		20.0 mL × 2
別売品		
Zn標準液 (200 μg/dL)		10 mL × 1
亜鉛コントロール(100 μg/dL)		10 mL × 1
亜鉛コントロール (H)		10 mL × 1

亜鉛を自動分析装置で測定しませんか？



アキュラスオート Zn の特長

- ※ 血清、血漿および尿中の亜鉛濃度を測定できます
- ※ 検体の前処理を必要としません
- ※ 原子吸光法との相関分析を行った結果、 $r=0.996$ でした (アキュラスオート Zn 電子添文より)

製造販売元

株式会社シノテスト

神奈川県相模原市南区大野台 4-1-93

<https://www.shino-test.co.jp>

《問い合わせ先》

株式会社シノテスト カスタマーサポート

TEL 0120-66-1141 FAX 042-753-1892

第7版：2024年7月

「やさしさ」からはじめる病院づくり


モニター目線を合わせる事によって情報確認の精度アップ！

Interpret compact

医用上下昇降デスク【インタープリットコンパクト】



画面を見る目線が異なる



画面を覗き込むような姿勢/頭の上から医師に話しかける状態



上下昇降します


「同じ目線で見る」画像確認の精度アップ、コミュニケーション向上

「+Standing のはたらし方」が人の身体に与える効果

公益財団法人 大原記念労働科学研究所との共同実験より


1 立ち仕事×座り仕事、もともと疲れにくい

パソコン作業中に立ちたり座ったりを定期的に戻した実験参加者は、座りや立ちの姿勢を眺めた人に比べて疲労度が低いという数値が出ています。姿勢を変えることで身体への負荷が分散され、疲れにくくなる事がわかります。



2 立ちたり座ったりを繰り返すと、足がむくみにくい

作業の前でふくらはぎの周囲を測ったところ、「立ち姿勢だけ」「座り姿勢だけ」の人と比較して、すの両方を定期的に戻した実験参加者は周囲の増加量ももっとも少なかったという結果が出ました。姿勢を変えることは、むくみにも有効だと言えます。



人を想い、場を創る。
okamura
オカムラの最新情報はQRコードでご確認ください
<https://www.okamura.co.jp/healthcare/>



お問い合わせ・ご相談は・・・

株式会社 オカムラ 浜松支店 〒430-7711浜松市中央区板屋町111-2浜松アクタワー11階
TEL 053-451-0081



経口FXa阻害剤

薬価基準収載

リクシアナ[®]錠・OD錠
15・30・60mg

一般名：エドキサバントシル酸塩水和物
処方箋医薬品 注意－医師等の処方箋により使用すること

●「効能又は効果」、「用法及び用量」、「警告・禁忌を含む注意事項等情報」等の詳細については、電子添文等をご参照ください。

製造販売元(文献請求先及び問い合わせ先を含む)



第一三共株式会社
東京都中央区日本橋本町3-5-1

2023年3月作成

安全で充実した 医療体制をSPDで支援

私たちは、SPD事業を行うホスピタルサポート企業です。
エア・ウォーターグループ各地の院外滅菌センターと
連携して幅広い医療機関へのきめ細やかで
安全なサービス提供をしています。

SPD物流センター：東京・大阪・福岡

グループ滅菌センター：全国23カ所


エア・ウォーターグループ
連結売上1兆円突破

※2022年度

地球の恵みを、社会の望みに。

AW エア・ウォーター・メディエイチ株式会社

AMR 対策のために適切な薬剤耐性菌検出検査を

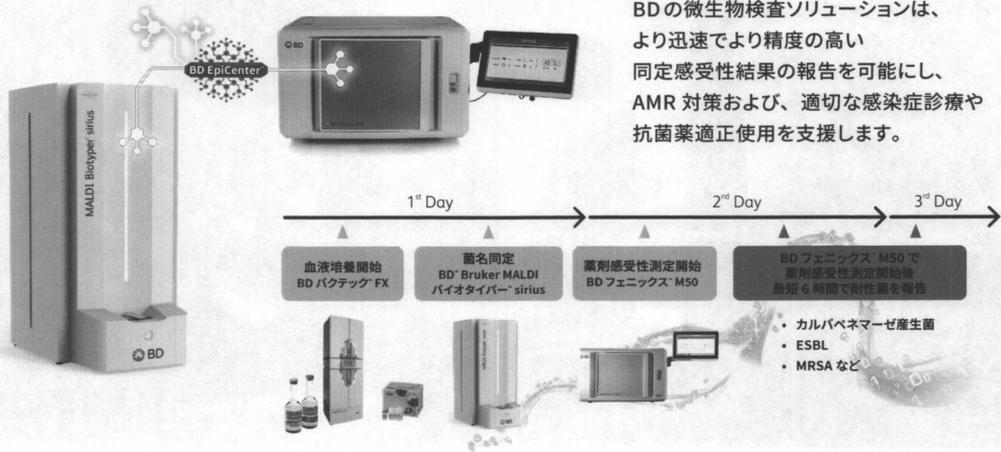


製造販売元
日本ベクトン・ディッキンソン株式会社
カスタマーサービス www.bd.j.co.jp/sl/cs/

販売名: BD Bruker MALDI バイオタイパー[®] sirius 製造販売届出番号: 13B1X10407000179
販売名: BD バクテック FX システム 製造販売届出番号: 13B1X10407000107
販売名: BD フェニックス M50 製造販売届出番号: 13B1X10407000159

bd.com/jp/

MALDI Biotyper is a trademark of Bruker Japan K.K.
BD, the BD Logo and all other trademarks are trademarks of Becton, Dickinson and Company or its affiliates. © 2024 BD. All rights reserved. M50MALDI-A5H4C_24

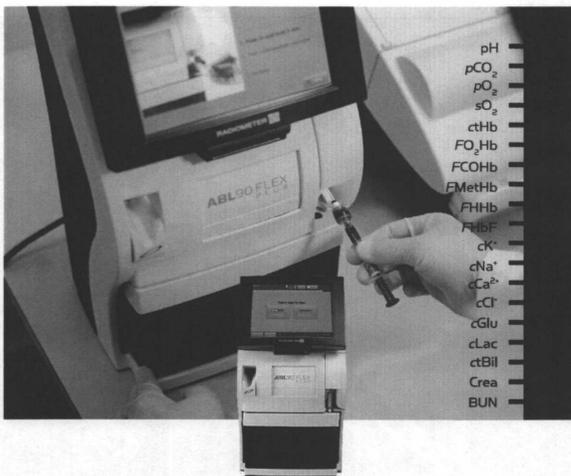


血液ガス分析装置

ABL90 FLEX PLUS

65μLのサンプル量からCrea/BUNを含む
19項目を35秒で測定

届出番号: 13B2X00079000014

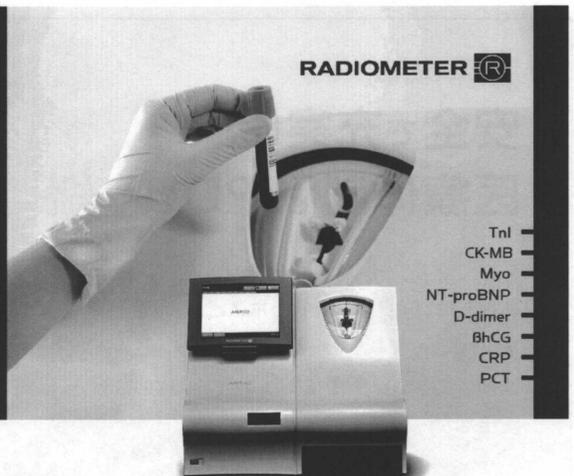

移動式免疫蛍光分析装置

AQT90 FLEX

心臓、凝固、感染症バイオマーカーなどの
POC測定を11~21分で実施

届出番号: 13B2X00079000004

最新の製品情報はこちらをご覧ください
www.radiometer.co.jp

アキュートケア支援サイト
www.acute-care.jp

製造販売元

ラジオメーター株式会社

本社〒140-0001 東京都品川区北品川4-7-35
TEL: 03-4331-3550 (代表)

24011801-R01



すべての人の健康のために

地域社会とつながり、予防・医療・介護のサービスを通じて「人」を支える

私たち八神製作所は

2021年、おかげさまで創業150周年を迎えました。

これまでの歴史を、これからの未来へつなぐ今

目の前の仕事のその先にある、健やかな人生を希って

予防・医療・介護の現場を支えること、

「地域」に寄り添いながら、頼られるサービスを届けることに

これからもひたむきに、取り組んでまいります。

YAGAMI

-Human Care Company-



株式会社 八神製作所

〒460-8318 愛知県名古屋市中区千代田二丁目16番30号
TEL. 052-251-6671 (代)

www.yagami.co.jp

福祉用具レンタル・介護用品販売の

ヤガミホームヘルスセンター

www.yagami.co.jp/yhhc



病院向けサービス



洗浄・消毒・滅菌

手術室から中央材料室まで



トータルサポート



手術室補助・清掃



内視鏡洗浄


医療現場を、あらゆる角度からサポート。



鴻池メディカル株式会社

<https://www.konoke-medical.co.jp/>



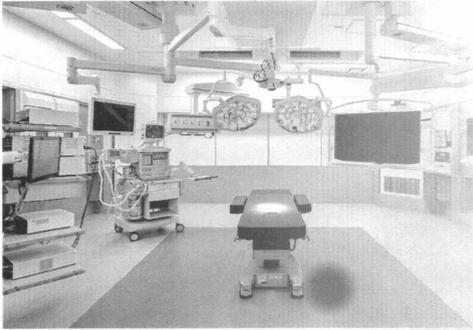

つかう人を、つくる人に。

私たちは医療設備メーカーとして、これまでたくさんの治療環境をつくってきました。大切にしてきたのは「当事者意識」を持つこと。治療に関わる人々の立場と視点で必要なことは何かを常に考えつづけました。

また、治療環境は一度つくったら終わりではありません。さまざまな変化に合わせて、環境を常にデザインしつづける必要があるのです。

このデザインの連続を乗り越えるためには、つかう人自身が、果敢に変化へ対応しつづけることが必要です。だから、私たちは自身が当事者意識を持つだけでなく、実際の当事者自身が治療環境をデザインしつづけられる、そんな仕組みをつくります。

つかう人をつくる人に。
当事者といっしょに何度でも変化に立ち向かう、そんな泥臭い姿勢が私たちのポリシーであり、誇りです。


USER TO BE DESIGNER

株式会社セントラルユニ

〒101-460-0003 名古屋市中区錦 3-5-31
オーキッドブレイス名古屋錦ビル 5F(名古屋支社)
TEL 052-972-6233 FAX 052-972-6238
<https://corporate.central-uni.co.jp/>


いのちをつなぐ、 私たちがいます。

どうすれば、大切ないのちを守るお手伝いができるだろう。
私たちが、ずっと考えてきたことです。
医療設備や医療機器にトラブルがあったら、
いつでも、どこでも、だれよりも早く駆けつける。
もちろん、私たちの使命です。
でも、そのトラブルはいのちを左右するかも知れない。
急いでも、間に合わないかも知れない。
医療ガス、それは、いつも安定して供給されることがあたりまえのライフライン。
だから、私たちは、トラブルが起きてしまう前の、
ふだんのメンテナンスの大切さを、決して譲りません。
医療ガスというあたりまえが、あたりまえであり続けること。
私たちは、その価値を知っています。
それは、大切ないのちにつながっているから。
変わらない安心を、揺るぎない信頼を、すべての病院に、すべての患者様に。
メンテナンスの確かな技術を知識、経験で支え続けます。
いのちをつなぐ、私たちがいます。

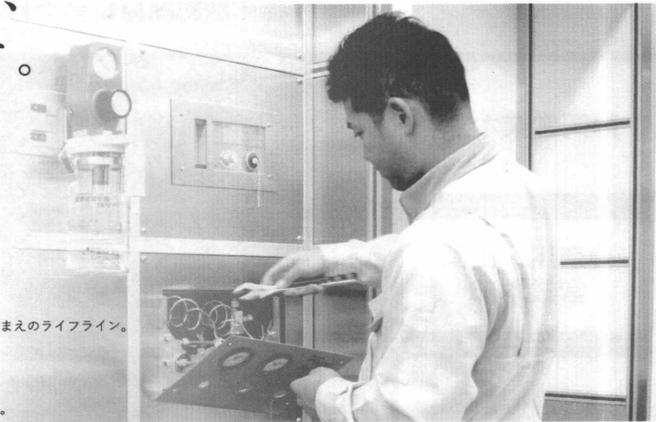

株式会社 エフエスユニ

〒422-8034 静岡県静岡市駿河区高松 1-11-26(静岡営業所)
TEL 054-237-6636 FAX 054-237-6673
<https://www.fs-uni.co.jp/index.html>

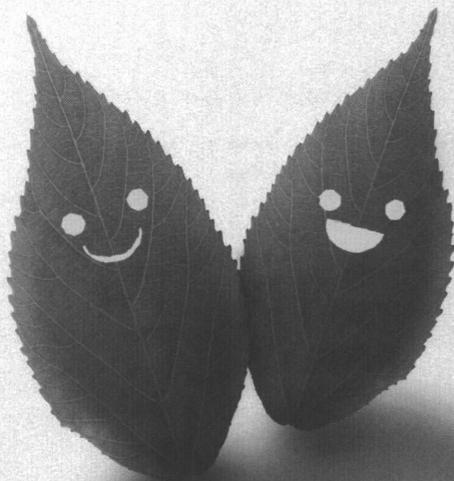

もっと、ずっと、これからも
医療現場に寄り添って。



静岡営業本部

[静岡支店] 静岡市駿河区池田156番地の2 Tel.054-655-6600
[沼津支店] 沼津市大岡3995-1 Tel.055-926-1100
[浜松支店] 浜松市中央区篠ヶ瀬町400 Tel.053-423-2110
[焼津支店] 焼津市大島817-1 Tel.054-623-2222
[掛川支店] 掛川市杉谷2-2-21 Tel.0537-22-2101

**神奈川・山梨
営業本部**

[甲府支店] 甲府市国母1-5-1 Tel.055-232-0010
[横浜支店] 横浜市都筑区中川中央2-4-8 Tel.045-595-2785
[関内支店] 横浜市中区相生町3-56-1KDX横浜関内ビル5F Tel.045-306-9111
[厚木支店] 厚木市酒井3068番地天幸第7ビル1F Tel.046-230-2500

**愛知・岐阜
営業本部**

[名古屋支店] 名古屋市昭和区御器所2-19-5 Tel.052-884-7370
[小牧支店] 小牧市中央3-258 Tel.0568-74-7351
[豊橋支店] 豊橋市東新町85 Tel.0532-57-6337
[岡崎支店] 岡崎市康生通南3-31第2マルワビル4F Tel.0564-64-6770
[岐阜支店] 岐阜市宇佐1-6-2 Tel.058-201-4111

ベネッセレ事業部

[静岡支店] 静岡市駿河区池田156番地の2 Tel.054-265-3001
[沼津支店] 沼津市大岡3995-1 Tel.055-926-1106
[浜松支店] 浜松市中央区篠ヶ瀬町400 Tel.053-423-2116
[岡崎支店] 岡崎市康生通南3-31第2マルワビル4F Tel.0564-64-5210



ヤンセンが目指すのは、 病が過去のものになる未来を作ることです。

世界のすべてが、私たちの研究室。
病と懸命に闘う患者さんのために、
高い科学技術、独創的な知性、
世界中の力を合わせ、新しい可能性を切り拓く。

すべては、私たちの解決策を待つ、ひとつの命のために。
複雑な課題にこそ挑んでいく。
新しい薬を創るだけでなく、それを最適な方法で提供する。

革新的な薬や治療法を、届ける。
世界中に、私たちを待つ人がいる限り。

誰もが健やかに、いきいきと暮らす社会。
そんな「当たり前」の願いのために、
自ら変化し、努力を続けます。

janssen
PHARMACEUTICAL COMPANIES OF
Johnson & Johnson

ヤンセンファーマ株式会社
www.janssen.com/japan
www.facebook.com/JanssenJapan

Nittobo

N-アッセイ

ニットーボー

LA FER-S

体外診断用医薬品

血清又は血漿中のフェリチン測定用試薬

● 低値から高値まで正確に測定可能です。

● 測定範囲 **5~2,200 ng/mL**

製造販売元

ニットーボーメディカル株式会社

〒963-8061 福島県郡山市富久山町福原字塩島1番地

問い合わせ先

〒102-0083 東京都千代田区麹町2丁目4番地1 麹町大通りビル7階

TEL.03-4582-5420 FAX.03-3238-4590 URL.<https://nittobo-nmd.co.jp>

HITACHI
Inspire the Next



診断データの効果的な
治療への活用方法とは？

治療に効果的な
診断技術とは？

いずれ、をいま、に。

私たちは一人ひとりに必要な診断・治療方法の確立をめざして、最先端の分析・自動化技術と治療技術、デジタルの融合により、ヘルスケア領域に新たな価値を提供していきます。

日立製作所ヘルスケア事業本部と日立ハイテクは2024年4月1日に統合し、新たな一歩を踏み出しました。

製品情報



コンセプトムービー



Innovating Healthcare, Embracing the Future

 株式会社 日立ハイテク

ヘルスケア事業統括本部
〒105-6409 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号 虎ノ門ヒルズビジネスタワー
お客様サポートセンター 03-3504-7211
北海道(札幌) 東北(仙台) 中部(名古屋) 関西(大阪) 九州(福岡)

OLYMPUS

両開きかつメリーランド型の先端形状



Surgical Energy Platform
USG-410 & ESG-410

製造販売元	オリンパスメディカルシステムズ株式会社
販売名	医療機器番号
パワースール	3040CEZX00265000
高周波手術装置 ESG-410	3040CEZX00264000
超音波/イボレーザー手術装置 USG-410	3020CEZX00056000

POWERSEAL

快適性を追求した高周波シーリングデバイス

POWERSEALは、シーリングデバイスに求められる多様なニーズをもとに設計されました。高い封止能をはじめ、人間工学に基づいたハンドルとメリーランド型の先端形状により直感的かつ快適な操作をサポートします。

主な特長

Strong Sealing

7mm以下の血管封止

Multi-functional Design

把持・剥離・止血など、
さまざまな機能で手術をサポート

Improved Ergonomics

人間工学に基づいたハンドルデザイン
により、手の疲労軽減をサポート

オリンパスマーケティング株式会社

www.olympus.co.jp

採血管準備装置

電子カルテ、検査システムと連携して、検体ラベルを採血管に自動貼付

i-pres core



●主な特長●

- ・採血管ランダム投入（一部）
- ・稼働中のラベル交換
- ・100本×15種類（最大24種類）
- ・20トレイ積上げ機能を搭載
- ・パッキングユニット対応

i-pres fine



●主な特長●

- ・省スペース設計
- ・ラベル切れプリンタ自動切換え
- ・100本×最大12種類
- ・10トレイ積上げ機能を搭載


採血業務支援システム RInCS

受付から採取完了まで採血業務を効率化

整理券発行



患者照合



誘導・呼出



機器・什器



採血指標化システム

採血運用の「質向上」に最適なツール

- ・患者採血難易度判定
- ・穿刺情報の活用
- ・採血時間短縮に貢献
- ・採血力量向上に活用



特許番号 6608660

お問い合わせ

中部支社 浜松営業所

〒430-0917
浜松市中央区常磐町145番地1号 大樹生命浜松ビル12F
TEL 053-455-4811

小林クリエイトホームページ

製品・サービスの詳細情報はこちらから
<https://k-cr.jp/product>

浜松医療センター



TOTAL DESIGN SOLUTION FIRM


KUME SEKKEI

久米設計

代表取締役社長 藤澤 進

〒135-8567 東京都江東区潮見2-1-22 TEL(03)5632-7811
東京 札幌 東北 横浜 中部 京都 大阪 九州 沖縄 上海 ハノイ ホーチミン シンガポール



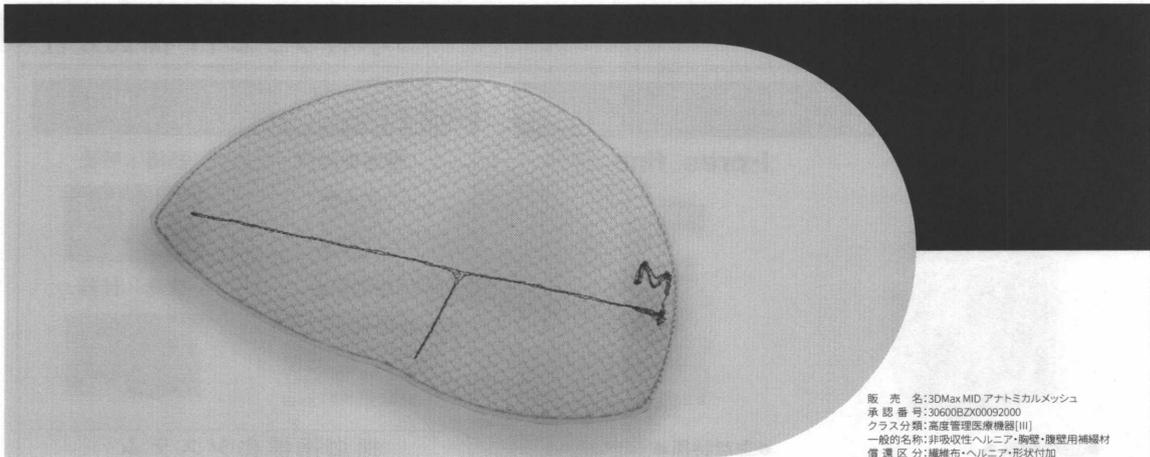

販売名: 3DMax MID アナトミカルメッシュ
 承認番号: 30601EZX00092000
 クラス分類: 高度管理医療機器(III)
 一般的名称: 非吸収性ヘルニア・膣壁・膈壁用補綴材
 償還区分: 繊維布・ヘルニア形状付加

鼠径ヘルニア修復用メッシュ

3D Max[®] (ミディアムタイプ)

TAPP法、TEP法およびRobotic TAPP法のような鏡視下アプローチのための
 立体型モノフィラメントポリプロピレンメッシュ

製造販売元

株式会社メディコン

カスタマーサービス www.bdj.co.jp/s/cs/

bd.com/jp/

・事前に必ず電子添文(注意事項等情報)を読み、本製品の使用目的、禁忌・禁止、警告、使用上の注意等を守り、
 使用方法に従って正しくご使用ください。
 ・本製品の電子添文は独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)のホームページで閲覧できます。



BD, the BD Logo, and all other trademarks are trademarks of Becton, Dickinson and Company or its affiliates. ©2024 BD. All rights reserved.



私たちは、人とテクノロジーの融合により、
 「安心して暮らせる地域社会」を支え続けます。



株式会社ソラスト

本社: 東京都港区港南2-15-3 品川インターシティC棟12階
 浜松オフィス: 静岡県浜松市中央区板屋町111-2 浜松アクトタワー11階

VOYANTTM
INTELLIGENT ENERGY SYSTEM

INTELLIGENT SEALING. CLEAR CHOICE.



Scan to
Learn More

販売名: Voyant エナジーシステム
医療機器製造販売承認番号: 30500BZX00133000

★単回使用(各ハンドピース)
★特定保守管理医療機器(ジェネレーター)
★添付文書、取扱説明書を必ずお読みになってからご使用ください

© 2024 Applied Medical Resources Corporation. All rights reserved.
Applied Medical, Appliedメディカルのロゴ、®または™のついた名称はApplied Medical Resources Corporationの登録商標で次の国で登録されています。オーストラリア、カナダ、日本、韓国、米国、英国、EU加盟国。

■製造販売元
Applied Medical Japan株式会社
〒101-0047 東京都千代田区内神田1-14-8
KANDA SQUARE GATE 6階
www.appliedmedical.co.jp

■製造業者
アプライドメディカル リソースズ社 アメリカ合衆国
www.appliedmedical.com

Applied
Medical 

09/2024 629863-JA-A

INTELLIGENT SEALING CLEAR CHOICE



See to
learn this

...the most intelligent sealing choice is clear choice. Clear choice is the only sealant that is 100% silicone based. It is the only sealant that is 100% clear. It is the only sealant that is 100% non-toxic. It is the only sealant that is 100% non-flammable. It is the only sealant that is 100% non-staining. It is the only sealant that is 100% non-yellowing. It is the only sealant that is 100% non-oxidizing. It is the only sealant that is 100% non-sagging. It is the only sealant that is 100% non-cracking. It is the only sealant that is 100% non-peeling. It is the only sealant that is 100% non-bubbling. It is the only sealant that is 100% non-brittling. It is the only sealant that is 100% non-aging. It is the only sealant that is 100% non-deteriorating. It is the only sealant that is 100% non-degrading. It is the only sealant that is 100% non-dissolving. It is the only sealant that is 100% non-evaporating. It is the only sealant that is 100% non-vaporizing. It is the only sealant that is 100% non-fuming. It is the only sealant that is 100% non-smoking. It is the only sealant that is 100% non-burning. It is the only sealant that is 100% non-igniting. It is the only sealant that is 100% non-explosive. It is the only sealant that is 100% non-toxic. It is the only sealant that is 100% non-flammable. It is the only sealant that is 100% non-staining. It is the only sealant that is 100% non-yellowing. It is the only sealant that is 100% non-oxidizing. It is the only sealant that is 100% non-sagging. It is the only sealant that is 100% non-cracking. It is the only sealant that is 100% non-peeling. It is the only sealant that is 100% non-bubbling. It is the only sealant that is 100% non-brittling. It is the only sealant that is 100% non-aging. It is the only sealant that is 100% non-deteriorating. It is the only sealant that is 100% non-degrading. It is the only sealant that is 100% non-dissolving. It is the only sealant that is 100% non-evaporating. It is the only sealant that is 100% non-vaporizing. It is the only sealant that is 100% non-fuming. It is the only sealant that is 100% non-smoking. It is the only sealant that is 100% non-burning. It is the only sealant that is 100% non-igniting. It is the only sealant that is 100% non-explosive.